Pipetas movettes

- De polietileno
- 3 tamaños : 1,5 , 4 y 5 ml
- Para muestras semicuantitativas

Ref.	Volumen (ml)	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
391474*	1,5	No	100	NC -
391475*	5	No	100	NC -

* Modelo económico



Pipetas de trasvase de amplia apertura

Facilita la manipulación de productos frágiles o de alta viscosidad.

- De LDPE
- Gran bulbo
- Longitud total : 125 mm
- Diámetro interno de la punta : 5,5 mm

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
380514	Pipetas de trasvase de amplia apertura	500	NC -




Cámaras de recuento de plástico Fast-Read 102®

Portaobjetos de PMMA con 10 rejillas para el recuento de células por µl

Volumen de la célula (µl)	7
Dimensiones de rejilla (mm)	5 x 2
Profundidad (mm)	0,1
Volumen de la rejilla (µl)	1
Dimensiones de un cuadrado (mm)	1 x 1
Volumen de un cuadrado (µl)	0,1
Volumen de la cámara (µl)	37

Ref.	Descripción	€
390497	Portaobjetos Fast-read® 10 cámaras x 100	NC -
390501	Bandeja de transporte para 10 portas	NC -
390498	Kit de 100 portaobjetos Fast-Read® 10 cámaras + 1000 pipetas de transferencia	NC -

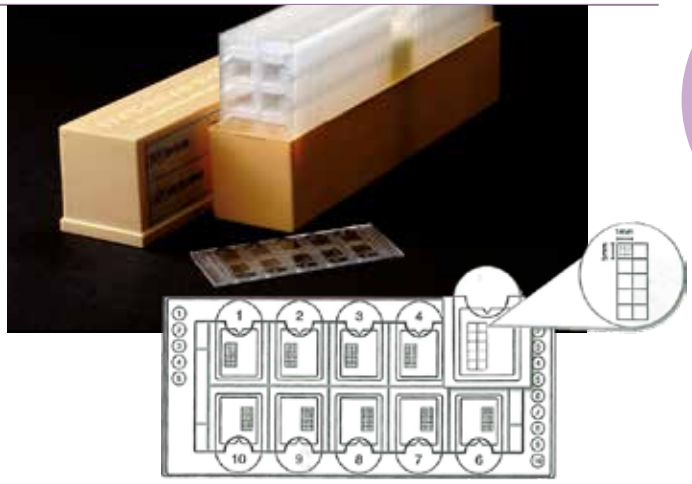


Sistema M-T® para Fast-Read 102®

El uso de la M-T® combinado con el sistema Fast-Read 102® reduce considerablemente el riesgo de confusión con otras celdas, lo que aumenta la precisión del resultado.


- Se utiliza para los exámenes de orina, evita la superposición de las células epiteliales durante la sedimentación
- Pipetas de transferencia M-T® : calibración especial que permite bloquear 1 ml de muestra en el fondo del tubo
- Tubos para el sistema M-T® : 16 x 103 mm, PS transparente, escala 1/2,5/5/10 ml

Ref.	Descripción	€
390508	1000 pipetas de transferencia M-T® + 1000 tubos de 10 ml	NC -
391536	Gradilla para 10 tubos	NC -
390503	Kit de 100 portaobjetos Fast-read® 10 cámaras + 1000 pipetas de transferenciaM-T®	NC -
390506	Kit de 100 portaobjetos Fast-read® 10 cámaras + 1000 pipetas de transferenciaM-T® + 1000 tubos de 10 ml + 1000 tapones	NC -
390522	Tubos cónicos 16 x 103 mm graduados de PS (2000 unid.)	NC -
390523	Tubos cónicos 16 x 103 mm graduados de PS (2000 unid.)	NC -
390517	Pipetas tribulbo para sistema M-T® (3000 unid.)	NC -

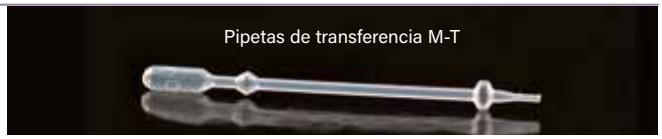

Principio

1. Colocar el tubo 390522 o 390523 que contiene la orina a analizar en la gradilla exprés 391536 y centrifugar
2. Insertar la pipeta de transferencia M-T de 3 bulbos
3. Dar la vuelta al estante
4. Se obtiene 1 ml de sedimento resuspendido listo para el análisis en portaobjetos Fast-Read 102®

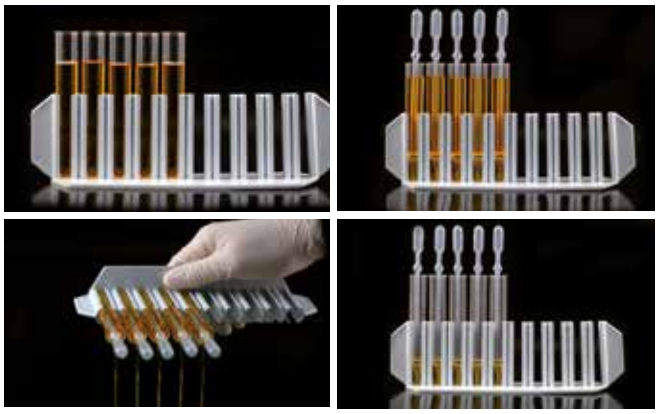

+ info en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB