


Cámaras de recuento


Cámaras de gran precisión de vidrio con estrías grabadas. Versión simple, con retícula doble, metalizadas (estrías transparentes para mejor contraste).



Malassez

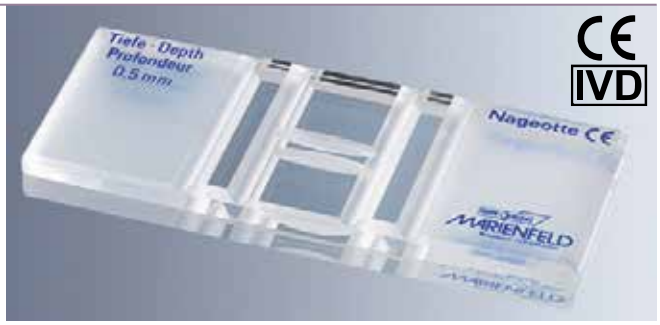

Thoma

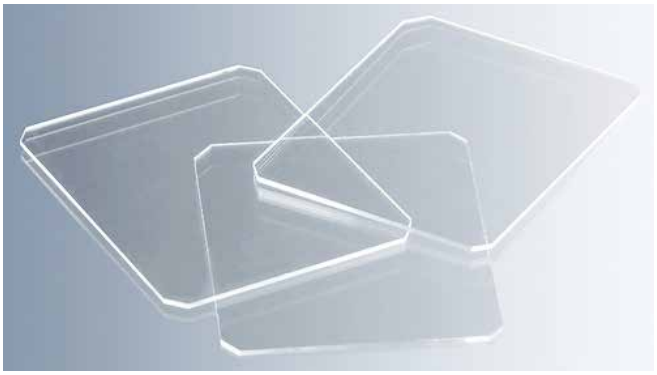

Nageotte


Neubauer


Neubauer mejorada


B Bürker




Cubres planas

Cámaras de recuento - aptas para el diagnóstico in vitro - con marcado CE - con doble rejilla de recuento

Tipo	Rejilla	Profundidad (mm)	Rejilla (mm²)	Recuento	Ref.	€
Malassez	Doble	0,2	5	Glóbulos rojos-Leucocitos	**140501**	**NC -**
Malassez	Doble metálica	0,2	5	Globular	**140533**	**NC -**
Malassez	Doble	0,2	5	Glóbulos rojos-Leucocitos	**900589****	**NC -**
Malassez	Doble metálica	0,2	5	Globular	**900590****	**NC -**
Thoma	Doble	0,1	1	Glóbulos rojos-Leucocitos	**140503**	**NC -**
Thoma	Doble metálica	0,1	1	Globular	**140535**	**NC -**
Nageotte	Doble	0,5	10	Raquídea	**140506**	**NC -**
Nageotte	Doble metálica	0,5	10	Raquídea	**140532**	**NC -**
Neubauer	Doble	0,1	3	Eritrocitos-Leucocitos	**140515**	**NC -**
Neubauer	Doble metálica	0,1	3	Eritrocitos-Leucocitos	**140528**	**NC -**
Neubauer mejorada	Doble	0,1	3	Eritrocitos-Leucocitos	**140514**	**NC -**
Neubauer mejorada*	Doble	0,02	3	Eritrocitos-Leucocitos	**140469**	**NC -**
Neubauer mejorada	Doble metálica	0,1	3	Eritrocitos-Leucocitos	**140527**	**NC -**
Bürker	Doble metálica	0,1	9	Glóbulos rojos-Leucocitos	**140529**	**NC -**

* Tipo Petroff ** Con pinzas.

Cubreobjetos pulidos para cámaras de recuento

Cubreobjetos destinados especialmente a cámaras de recuento. Grosor : 0,4 mm.

Ref.	L x An (mm)	Para cámaras	De tipo	Unid./ caja	€/ caja
140537	22 x 22	Simple	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	**NC -**
140536	20 x 26	Doble	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	**NC -**
140583B*	22 x 32	Doble	Nageotte	100	**NC -**
900596*	30 x 30	Doble	Nageotte	100	**NC -**

* Grosor n° 1.

Cámara de recuento Neubauer de alta precisión



- Cámara de gran precisión para diagnóstico in-vitro con línea de recuento negra o transparente
- El sistema V-slash facilita el depósito por capilaridad y reduce el riesgo de desbordamiento
- Aprobado para la utilización en diagnóstico in-vitro, marcado CE / IVD según Directiva 98/79/CE

Ref.	Tipo	Color línea recuento	€
900504	Neubauer mejorada	Negro	**NC -**
900505	Neubauer mejorada	Transparente	**NC -**