
Spitzen PIPETMAN® DIAMOND Gilson

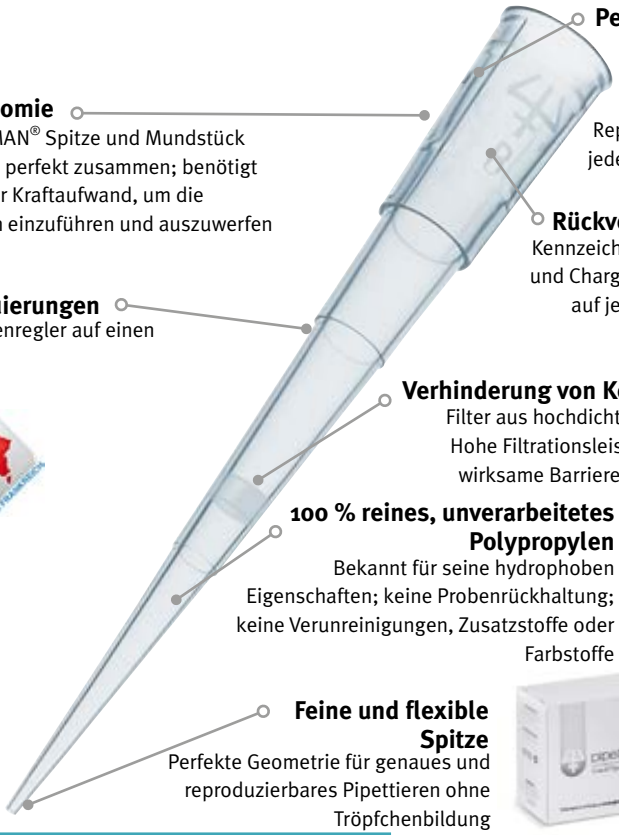

Ergonomie
PIPETMAN® Spitze und Mundstück passen perfekt zusammen; benötigt weniger Kraftaufwand, um die Spitzen einzuführen und auszuwerfen

Graduierungen
Volumenregler auf einen Blick

Perfekt versiegelt
Dichtungsring gewährleistet Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit bei jedem Pipettiervorgang

Vollständige Rückverfolgbarkeit
Kennzeichnung, Farbcode und Chargennummer sind auf jeder Verpackung nachvollziehbar

Verhinderung von Kontamination
Filter aus hochdichtem Polyethylen. Hohe Filtrationsleistung bietet eine wirksame Barriere gegen Aerosole

100 % reines, unverarbeitetes Polypropylen
Bekannt für seine hydrophoben Eigenschaften; keine Probenrückhaltung; keine Verunreinigungen, Zusatzstoffe oder Farbstoffe

Feine und flexible Spitze
Perfekte Geometrie für genaues und reproduzierbares Pipettieren ohne Tröpfchenbildung

- **Sterilisierte Spitzen garantiert frei von RNasen, DNasen, RNA, DNA, ATP, Pyrogenen und nachweisbaren Spurenmetallen**
- **Erfüllt europäische Qualitätsstandards Richtlinie 98/79/EG**
- **Qualitätszertifikate zum Herunterladen auf der Gilson-Website**

Vorführungen :
- **TOWERPACK**, Ladesystem. Ideal für Mehrkanalpipetten dank des ROCKY RACK-Systems, einer Ablage, die die Platzierung der Spitzen optimiert. Autoklavierbar, recycelbar. (anzuwenden mit leeren Boxen Nr. 066173 - siehe unten auf der Seite)
- **TIPACK**, kompakte, praktische, ergonomische und einfach zu bedienende Racks mit 8 oder 12 Kanalpipetten (ROCKY RACK System)
- **STERILPACK**, einzeln in Blister verpackt
- **ECOPACK** und **EASYPACK**, Lose-Format (Beutel)
- **BLISTER REFILL** : Nachfüllpackung im Blister mit 96 Spitzen
- **RELOAD PACK** : einfaches und kostengünstiges Ladesystem




RELOAD PACK


BLISTER REFILL

Standard Spitzen PIPETMAN® DIAMOND Gilson

Volumen	Typ		Lose EASY PACK	Lose ECO PACK	TIPACK	TIPACK sterilisiert	BLISTER REFILL*	REFILL BLISTER sterilisiert*	RELOAD PACK*	TOWER PACK**	TOWER PACK sterilisiert**	Leer-Rack	STERILPACK
0,1 - 10 µl	D10	Art. Nr.	066022	066029	066034	066039	-	-	-	066044	066049	066054	-
		Packungseinheit	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-	-	-	AA -	AA -	AA -	-
0,1 - 20 µl	DL10***	Art. Nr.	066023	066030	066035	066040	070074	070077	070085	066045	066050	066055	-
		Packungseinheit	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	-
		CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	-
2 - 200 µl	D200	Art. Nr.	066024	066031	066036	066041	070075	070078	070086	066046	066051	066056	066199
		Packungseinheit	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	400
		CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
20 - 300 µl	D300	Art. Nr.	066025	066032	066037	066042	-	-	-	066047	066052	066057	-
		Packungseinheit	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-	-	-	AA -	AA -	AA -	-
200 - 1000 µl	D1000	Art. Nr.	066026	066033	066038	066043	070076	070079	070087	066048	066053	066058	066200
		Packungseinheit	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	6 x 96	7 x 96	7 x 96	2	400
		CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
100 - 1200 µl	D1200	Art. Nr.	066406	066405	066407	066408	-	-	-	-	-	-	-
		Packungseinheit	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	-	-	-	-
		CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-	-	-	-	-	-	-
1- 5 ml	D5000	Art. Nr.	066027	-	066190	-	-	-	-	-	-	066193	-
		Packungseinheit	3 x 334	-	12 x 50	-	-	-	-	-	-	1	-
		CHF	AA -	-	AA -	-	-	-	-	-	-	AA -	-
1- 10 ml	D10 ml	Art. Nr.	066028	-	066191	-	-	-	-	-	-	066192	-
		Packungseinheit	4 x 50	-	8 x 30	-	-	-	-	-	-	1	-
		CHF	AA -	-	AA -	-	-	-	-	-	-	AA -	-

* Kann mit leeren Boxen für manuelle Nachfüllungen verwendet werden

*Kann mit leeren TOWER PACK-Nachfüllboxen verwendet werden

*Längere 10µl-Spitzen zum einfachen Pipettieren in Mikroröhrchen



Leere Boxen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
070096	Leere Box für Nachfüllungen von Hand 10 µl und 200 µl	2	AA -
070097	leere Box für manuelle Nachfüllungen 1000 µl	2	AA -
066173	leere Box für TOWER PACK Nachfüllpackung	1	AA -




Setzen Sie den Turm auf die Nachfüllbox. Fest drücken.


Das Spitzen-Tablett ist an seinem Platz.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com