
Bowie-Dick Browne Pack für Autoklaven

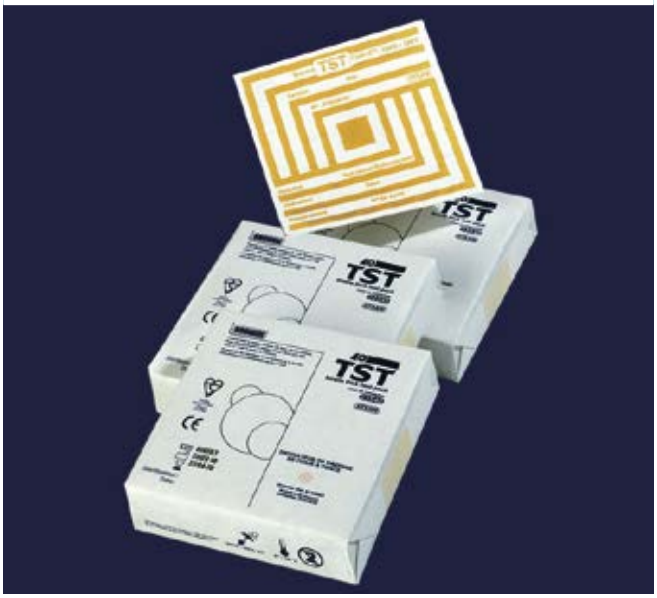

Gebrauchsfertige Testpackung Typ Bowie-Dick für Wasserdampfsterilisatoren. Indikator zur Verwendung in spezifischen Tests gemäß EN 867-1 Klasse B und 867-4 sowie ISO 11140 Klasse 2. Gebrauchsanweisung: Platzieren Sie den Test in der Mitte des oberen Regals und führen Sie einen BD-Zyklus durch. Packung öffnen und das Blatt überprüfen : Der erfolgreiche Test ist blau, eine andere Farbe bedeutet einen Misserfolg.

- **Farbumschlag: von Gelb nach Blau**
- **Einweg**
- **Medizinische Vorrichtung mit CE-Kennzeichnung**
- **(B x L x H) (mm): 125 x 125 x 30**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tests/ Packung	CHF/ Packung
972455	Bowie-Dick Browne Pack für Autoklav	20 Tests	AA -

Bowie & Dick "Mini-Control Pack" Test



Dampfdurchdringungstest "Mini-Control Pack".

- **Bleifreie Tinte**
- **Wendung von blau zu schwarz**
- **Stabilität der Wendung über mehrere Jahre**
- **Normen : EN ISO 11140-1 (Klasse 2) und EN ISO 11140-4**
- **Verwendbar in großen oder kleinen Sterilisatoren des Typs b (EN 13060)**
- **Blätter aus Löschpapier, die die Einschränkungen des Original-Tests von Bowie & Dick wiedergeben**
- **Minimale Expositionsbedingungen : 134 °C, Sattdampf für 3 Minuten 30 Sek. oder 121 °C bei Sattdampf für 15 Minuten**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tests/ Packung	CHF/ Packung
095040	Test Mini-control Pack	30 Tests	AA -

Test von Bowie & Dick VISA



Um den täglichen Dampfdurchdringungstest anzugehen.
Das Testblatt wird in einer „Sandwich"-Form innerhalb von 2 Laminatschichten platziert, die die Belastung durch Dampfdurchdringung nachbildet gemäß EN 11140-4 . Die Abschaffung des Papierbündels verbessert die Auflagen für die Abfallentsorgung.

- **Bleifreie Tinte**
- **Farbe der Wendung von rosa nach grün**
- **Geringer Platzbedarf: erleichtert die Lagerbedingungen**
- **Reproduzierbarkeit und Stabilität der Wendung nach der Sterilisation (stabil über mehrere Jahre)**
- **Testblatt vom Typ „Löschblatt" zwischen zwei Laminatschichten: Beseitigung des Verpackungspakets aus Papier**
- **Minimale Expositionsbedingungen : 134 °C bei gesättigtem Dampf für 3 Minuten 30 Sekunden, 121 °C bei gesättigtem Dampf für 15 Minuten**
- **Normen : EN ISO 11140-1 (Klasse 2) und EN ISO 11140-4**

Art. Nr.	Bezeichnung	Tests/ Packung	CHF/ Packung
095096	Bowie & Dick Test VISA	120 Tests	AA -

Prion-Emulator 134-18 NS



Der Prion 134-18 NS-Emulator ist ein Multiparameter-Indikator der Klasse 6 (Temperatur, Zeit und Sattdampf). Es wird bei der Dampfsterilisation verwendet, Prion-Zyklus 134 °C / 18 Minuten.

- **Nicht-sequentieller Emulator der Klasse 6**
- **Multiparameter (Zeit/Temperatur/Dampfkontakt)**
- **Entwickelt, um die Schwelle für die Erkennung möglicher Fehlfunktionen zu verbessern**
- **Chemisch-physikalische Tinte**
- **2 Seiten laminiert, um Migration zu verhindern**
- **Konformität mit EN ISO 11140-1**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ Box
095089	Prion-Emulator 134-18 NS	250	AA -

Indikatoren für die Sterilisation mit Gammastrahlen

- **Selbstklebende Etiketten mit einem Durchmesser von 12,5 mm**
- **Aufbewahrung im Kühlschrank zwischen 5 und 10 °C**
- **Exposition > 10 kGy: Farbwechsel von gelb zu rot**
- **Lebensdauer von 24 Monaten**

Art. Nr.	Bezeichnung	Etiketten/ Rolle	CHF/ Rolle
071500	Runde Etiketten Gamma-Sterilisationsindikator	5000	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com