Im Prüfbereich (96×Ø6.6) je 15/3×0.063
In max. 40 Näpfchen ist zusätzlich zulässig: 5/1×0.4 (Löcher)
Außerhalb des Prüfbereiches 15/20×0.25, 1/3×1.6
Inside optical critical section 15/3×0.063 as per DIN 58170/54
In max. 40 wells permitted digs in cylinder surface : 5/1×0.4 as per DIN 3140/7
Outside optical critical section 15/20×0.25 as per DIN 58170/54, 1/3×1.6 as per DIN 3140/2

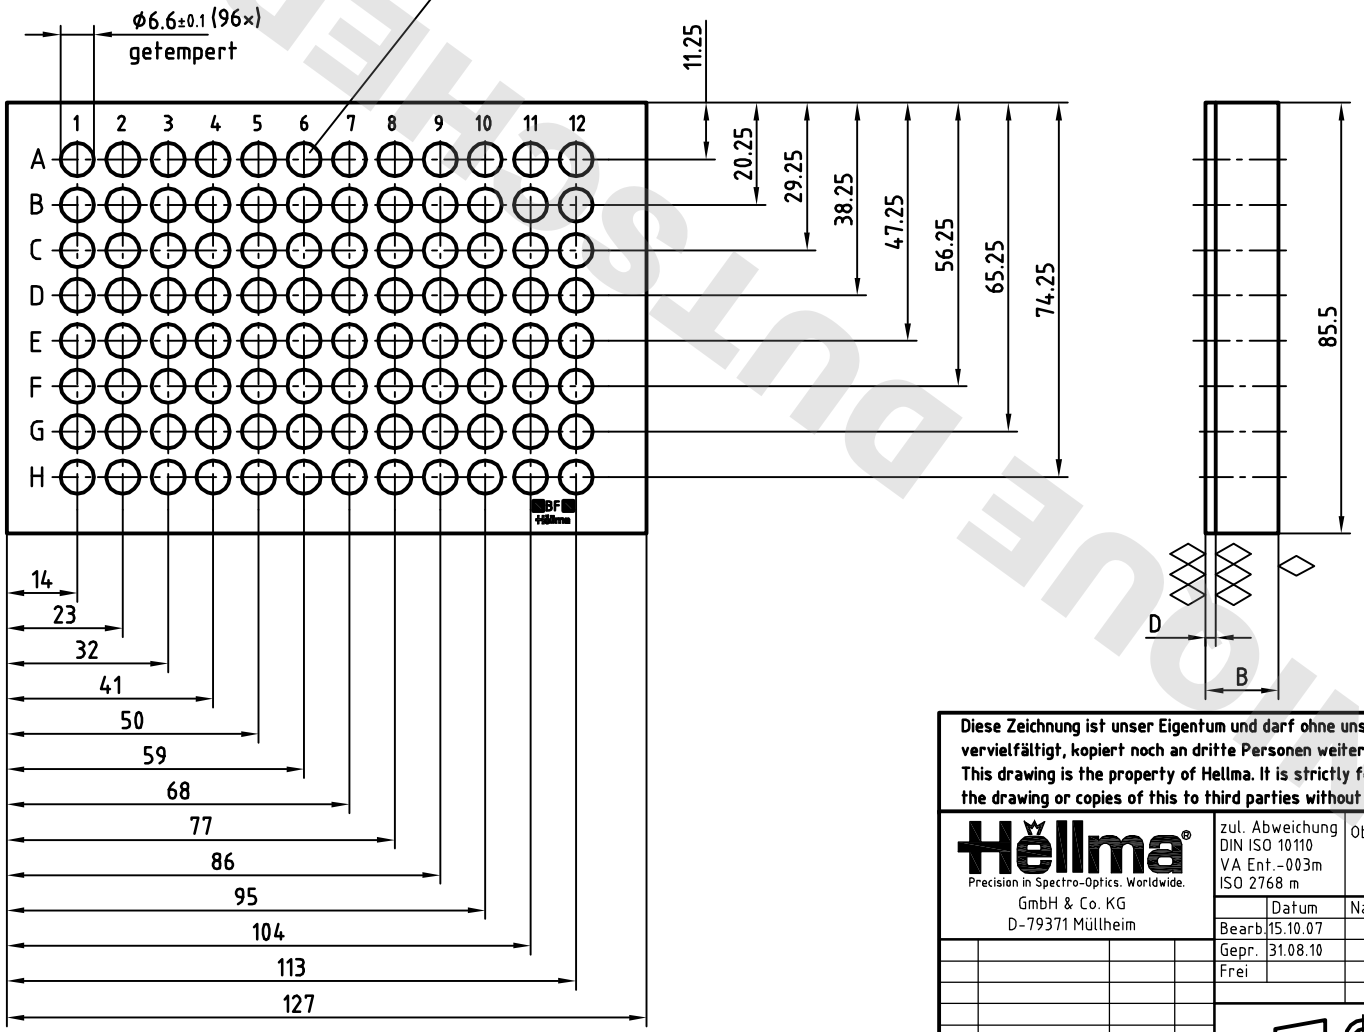

Alle Achsabstände ±0.1
Alle Außenkanten gefast 0.5–1×45°
Direkt verschmolzen

All hole locations ±0.1
All edges chamfered 0.5–1×45°
Directly fused

III	2 -0.2	14.5 -1
II	1 -0.1	13.5 -1
I	0.5 ±0.05	13 -1
Version	D	B

Zur Kundeninformation wird bei Änderung nicht mit erfaßt.

This copy is only for customer information and will not be updated

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, kopiert noch an dritte Personen weitergegeben werden.
This drawing is the property of Hellma. It is strictly forbidden to show or distribute the drawing or copies of this to third parties without permission of the Company in writing.

Hellma®
Precision in Spectro-Optics. Worldwide.
GmbH & Co. KG
D-79371 Müllheim

zul. Abweichung DIN ISO 10110 VA Ent.-003m ISO 2768 m
Oberfläche
Maßstab/Scale 1:1
Material Schott Borofloat;

	Datum	Name
Bearb.	15.10.07	wg
Gepr.	31.08.10	We
Frei		

Mikrotestplatte
Microplate

Zeichng.-Nr./Drawing-No. 730.009_4
Blatt Bl.

Zust. | Änderung | Datum | Name | Datei: 730_009_4 | Ers. f.: | Ers. d.: