B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CATALOGUE DE VENTE
SERINGUES ET AIGUILLES
PERFUSION DM



PRÉCISION DANS LA PRÉPARATION, L'INJECTION ET L'ADMINISTRATION

Pour une préparation, une injection et une administration précises, B. Braun propose une gamme complète de seringues et d'aiguilles à usage unique.

La gamme de seringues à usage unique comprend des seringues 2 et 3 pièces, des seringues 3 pièces pour pousse-seringues, seringues à tuberculine et héparine, ainsi que des seringues à insuline.

La gamme d'aiguilles à usage unique comprend des aiguilles hypodermiques standards et sécurisées, des aiguilles pour les stylos d'insuline ainsi que des aiguilles pour les préparations médicamenteuses.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sommaire

SERINGUES



Seringues 2 pièces

Injekt® Embout Luer 8
Injekt® Embout Luer Lock 9

Seringues 2 pièces tuberculine embout Luer

Injekt®-F Embout Luer 10
Injekt®-F Luer Duo 10
Injekt® : présentation de la boîte 11



Seringues 3 pièces

Omnifix® Embout Luer 14
Omnifix® Embout Luer Lock 15
Omnifix® : présentation de la boîte 16

Seringues 3 pièces tuberculine/héparine

Omnifix®-F Embout Luer Lock 19
Omnifix®-F Embout Luer 20
Omnican® F 21



Seringues 3 pièces pour pousse-seringues

Original Perfusor® 20 ml 23
Original Perfusor® 50 ml 23



Seringues 3 pièces à insuline

Omnifix® 100 26
Omnifix® 50 27
Omnican® 100 27

AIGUILLES



Aiguilles pour stylo injecteur

Omnican® fine 29



Aiguilles hypodermiques standards

Sterican® 31

Aiguilles pour préparation médicamenteuse

SOL-M 34



Aiguilles hypodermiques sécurisées

Sterican® Safety 36
Sterican® Safety : description du produit 38
Sterican® Safety : Instructions de manipulation 40

CONTENEURS POUR L'ÉLIMINATION DES DASRI



Medibox® 43
Medibox® : Instructions de manipulation 44

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Seringues 2 pièces

Injekt®, Injekt®-F

Avec Injekt®, B. Braun propose une large gamme de seringues 2 pièces à usage unique avec des embouts Luer et Luer Lock de différentes tailles.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Injekt® Embout Luer

Seringue 2 pièces avec embout Luer



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Piston vert
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire
- Butée de piston intégrée (1)
- Graduations complémentaires au-delà de la capacité nominale
- Embout Luer
- Corps de seringue en polypropylène
- Piston en polyéthylène
- Fabriqué sans huile de silicone, PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile





Injekt® Embout Luer, fabriqué selon la norme ISO 7886-1.

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
2 ml	Centré	0.1 ml	3.0 ml	100 pièces	4606027V
5 ml	Excentré	0.2 ml	6.0 ml		4606051V
10 ml	Excentré	0.5 ml	12.0 ml		4606108V
20 ml	Excentré	1.0 ml	24.0 ml		4606205V

Injekt® Embout Luer Lock

Seringue 2 pièces avec embout Luer Lock



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Piston vert
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire
- Butée de piston intégrée (1)
- Graduations complémentaires au-delà de la capacité nominale
- Embout Luer Lock
- Corps de seringue en polypropylène
- Piston en polyéthylène
- Fabriqué sans huile de silicone, PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile





Injekt® Embout Luer Lock, fabriqué selon la norme ISO 7886-1.


Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
2 ml	Centré	0.1 ml	3.0 ml	100 pièces	4606701V
5 ml	Centré	0.2 ml	6.0 ml		4606710V
10 ml	Centré	0.5 ml	12.0 ml		4606728V
20 ml	Centré	1.0 ml	24.0 ml		4606736V

Seringues hypodermiques 2 pièces, dispositif médical de classe I stérile avec fonction de mesurage (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Injekt®-F

Seringue 2 pièces tuberculine/héparine embout Luer

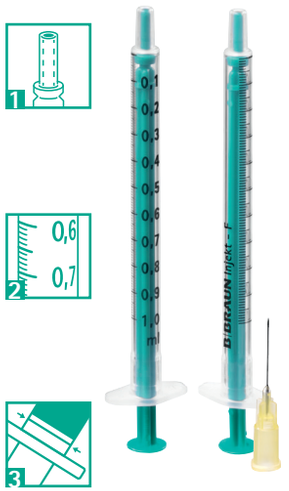

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Graduation fine de 0.01 ml (2)
- Piston vert
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire
- Piston à ergot (1)
- Butée de piston intégrée (3)
- Embout Luer
- Corps de seringue en polypropylène
- Piston en polyéthylène
- Fabriqué sans huile de silicone, PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile
- Seringue avec ou sans aiguille

Injekt®-F Embout Luer, fabriqué selon la norme ISO 7886-1

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
1 ml	Centré	0.01 ml	1.0 ml	100 pièces	9166017V


Injekt®-F Luer Duo, fabriqué selon la norme ISO 7886-1 fournie avec aiguille Sterican® (25G/0.5 x 16 mm) fabriquée selon la norme ISO 7864


Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
1 ml	Centré	0.01 ml	1.0 ml	100 pièces	9166033V

Seringues tuberculines 2 pièces, sans aiguille (dispositif médical de classe I stérile avec fonction de mesurage), avec aiguille (classe IIa) (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne


Injekt®

Présentation de la boîte

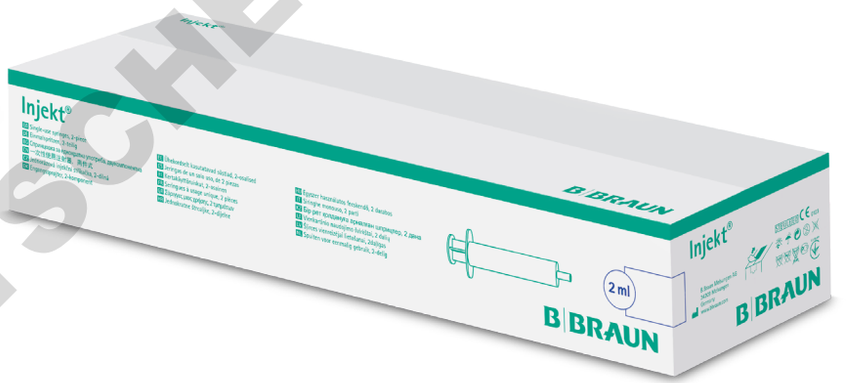

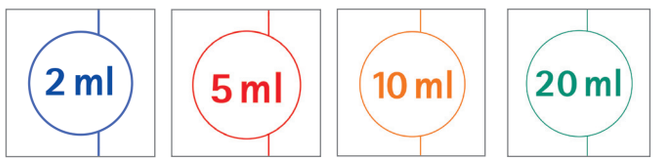

- Emballage avec code couleur pour différencier les versions



- Illustration du produit pour une meilleure identification



- Nom du produit sur toutes les faces pour une identification

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Seringues 3 pièces et Seringues tuberculine/héparine

Omnifix®, Omnifix®-F, Omnican® F

Avec Omnifix®, B. Braun propose une large gamme de seringues 3 pièces à usage unique avec des embouts Luer et Luer Lock de différentes tailles.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Omnifix® Embout Luer


Seringue 3 pièces avec embout Luer



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps de seringue transparent
- Graduation à fort contraste
- Butée de piston intégrée (1)
- Graduation complémentaire au-delà de la capacité nominale pour 2 ml, 10 ml et 50 ml
- Embout Luer
- Corps de seringue et piston en polypropylène
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile



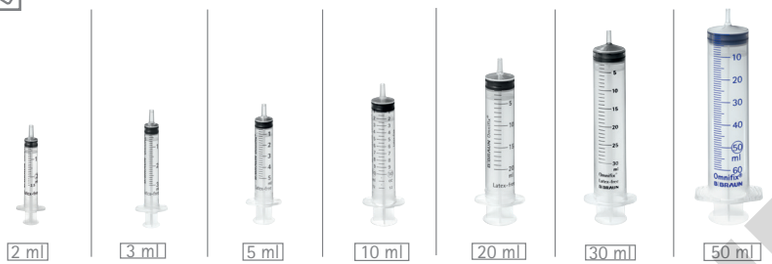

Omnifix® Embout Luer, fabriqué selon la norme ISO 7886-1

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
2 ml	Centré	0.1 ml	2.5 ml		4616022V
3 ml	Centré	0.1 ml	3.0 ml		4616025V
5 ml	Excentré	0.2 ml	5.0 ml		4616057V
10 ml	Excentré	0.5 ml	12.0 ml	100 pièces.	4616103V
20 ml	Excentré	1.0 ml	20.0 ml		4616200V
30 ml	Excentré	1.0 ml	30.0 ml		4616308F
50 ml	Excentré	1.0 ml	60.0 ml		4616502F

Seringues hypodermiques 3 pièces, dispositif médical de classe I stérile avec fonction de mesurage (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

Omnifix® Embout Luer Lock


Seringue 3 pièces avec embout Luer Lock



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps de seringue transparent
- Graduation à fort contraste
- Butée de piston intégrée (1)
- Graduation complémentaire au-delà de la capacité nominale pour 2 ml, 10 ml et 50 ml
- Embout Luer Lock
- Corps de seringue et piston en polypropylène
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile



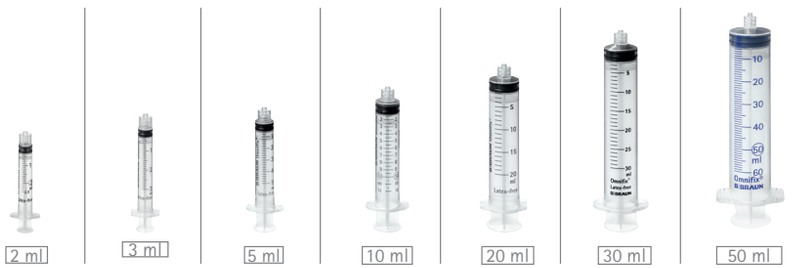

Omnifix® Embout Luer Lock, fabriqué selon les normes ISO 7886-1 et ISO 7886-2


Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
2 ml	Centré	0.1 ml	2.5 ml		4617029V
3 ml	Centré	0.1 ml	3.0 ml		4617022V
5 ml	Centré	0.2 ml	5.0 ml		4617053V
10 ml	Centré	0.5 ml	12.0 ml	100 pièces	4617100V
20 ml	Centré	1.0 ml	20.0 ml		4617207V
30 ml	Centré	1.0 ml	30.0 ml		4617304F
50 ml	Centré	1.0 ml	60.0 ml		4617509F

Seringues hypodermiques 3 pièces, dispositif médical de classe IIa (CE 0123)| Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Omnifix®


Présentation de la boîte

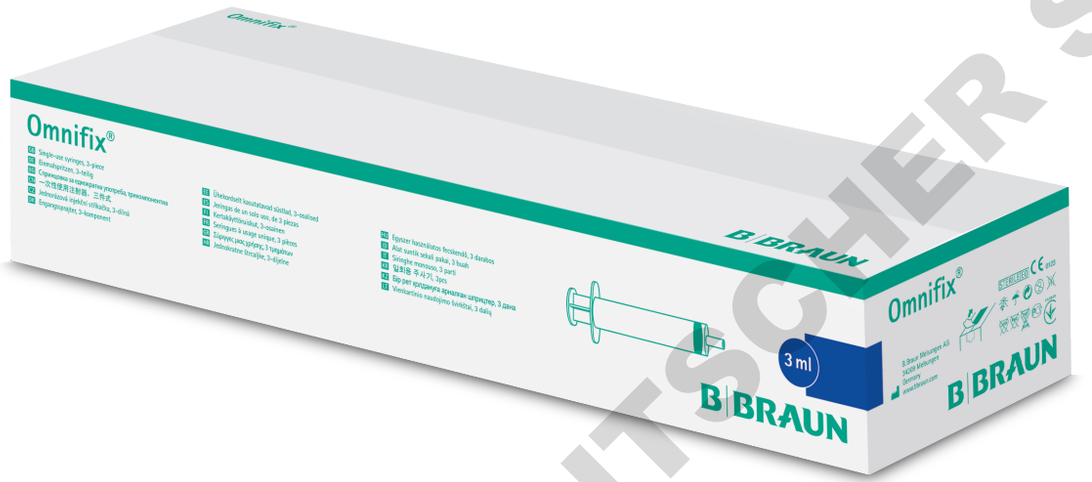



- Emballage avec code couleur pour une différenciation des versions

- Illustration du produit pour une identification





- Nom du produit sur tous les côtés pour une identification

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Omnifix®-F

Seringue 3 pièces tuberculine/héparine avec embout Luer Lock



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Espace Mort Faible (EMF) : Piston à ergot (1)
- Graduation fine de 0.01 ml (2)
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire à fort contraste
- Butée de piston intégrée (3)
- Embout Luer Lock
- Corps de seringue en polypropylène et piston en polystyrène
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

Omnifix®-F Embout Luer Lock (Type EMF), fabriqué selon la norme ISO 7886-1


Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîtes	Référence
1 ml	Centré	0.01 ml	1.0 ml	100 pièces	9167006V

Seringues tuberculines 3 pièces, dispositif médical de classe I stérile avec fonction de mesurage (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Omnifix®-F

Seringue 3 pièces tuberculine/héparine avec embout Luer

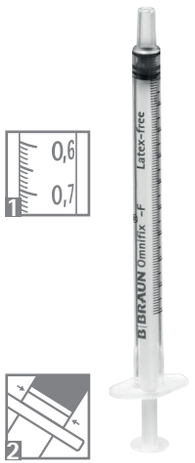

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Graduation fine de 0.01 ml (1)
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire à fort contraste
- Butée de piston intégrée (2)
- Embout Luer
- Corps de seringue en polypropylène et piston en polystyrène
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

Omnifix®-F Embout Luer, fabriqué selon la norme ISO 7886-1

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîtes	Référence
1 ml	Centré	0.01 ml	1.0 ml	100 pièces	9161406V

Seringue tuberculine 3 pièces, dispositif médical de classe I stérile avec fonction de mesurage (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

Omnican® F

Seringue 3 pièces tuberculine/héparine avec aiguille intégrée

Sous blister individuel



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Aiguille intégrée
- Graduation fine de 0.01 ml (1)
- Capuchon de protection transparent
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire à fort contraste
- Butée de piston intégrée (2)
- Corps de seringue en polypropylène et piston en polystyrène
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Volume mort minimal
- Sans PVC, Latex et DEHP

Omnican®-F, fabriquée conformément à la norme ISO 7886-1, avec aiguille intégrée (30G/0.30 x 12 mm) fabriquée conformément à la norme ISO 7864

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîte	Référence
1 ml	Centré	0.01 ml	1.0 ml	100 pièces.	9161502S

Seringue tuberculine 3 pièces, dispositif médical de classe IIa (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Original Perfusor®

Seringue 3 pièces pour pousse-seringues



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps de seringue transparent
- Graduation à fort contraste
- Butée de piston intégrée (1)
- Corps de seringue et piston en polypropylène
- Embout Luer Lock
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (20 mL en bromobutyle / 50mL en polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile



20 ml



50 ml

Original Perfusor® 20 ml, fabriqué selon les normes ISO 7886-1 et ISO 7886-2

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîtes	Référence
20 ml	Centré	1.0 ml	20 ml	50 pièces.	8728615

Original Perfusor® 50 ml, fabriqué selon les normes ISO 7886-1 et ISO 7886-2

Taille	Cône	Graduation	Graduation complémentaire	Unités par boîtes	Référence
50 ml	Centré	1.0 ml	50 ml	100 pièces.	8728844F-06

Seringue 3 pièces pour pousse-seringue, dispositif médical de classe IIa (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Seringues à insuline Omnifix® et Omnican®

Seringues 3 pièces à insuline


Pour l'administration d'insuline, B. Braun propose une large gamme de seringues à insuline 3 pièces. La gamme comprend les seringues à insuline Omnifix® à 3 pièces et les seringues à insuline Omnican® à 3 pièces avec aiguille intégrée.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Omnifix® Seringues à Insuline

Seringue 3 pièces à insuline pour 100 U avec embout Luer

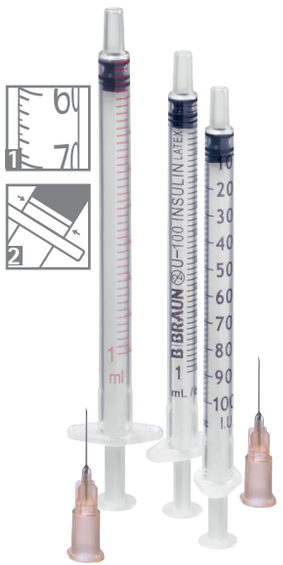

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Graduation de 2.0 UI pour l'insuline 100 U (Omnifix® 100) (1)
- Corps de seringue transparent
- Graduation à fort contraste
- Butée de piston intégrée (2)
- Versions avec et sans aiguille
- Corps de seringue en polypropylène et piston en polystyrène
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

UI = Unité Internationale

Omnifix® 100 pour insuline 100 U avec embout Luer, fabriquée conformément à la norme ISO 8537, sans ou avec aiguille (26G/045. x 12 mm) fabriquée conformément à la norme ISO 7864

100 U

Taille	Graduation / valeur d'echelle	Graduation complémentaire	Ø x Longueur (aiguille)	Unités par boîte	Référence
1 ml	100 U / 2 UI	1.0 ml	-	100 pièces	9161708V
1 ml	100 U / 2 UI	1.0 ml	0.45 x 12 mm		9161376V


Seringue 3 pièces à insuline, dispositif médical de classe IIa (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

Omnican® Seringues à Insuline

Seringue 3 pièces à insuline pour 100 U avec aiguille intégrée

Sous blister individuel

Pour 50 UI

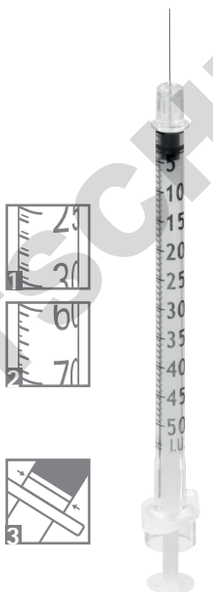


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Graduation de 1.0 UI pour (Omnican® 50) (1) ou 2.0 UI (Omnican® 100) (2)
- 100 UI = capuchon de protection orange
- Corps de seringue transparent
- Graduation noire à fort contraste
- Butée de piston intégrée (3)
- Corps de seringue en polypropylène et piston en polystyrène
- Capuchon de protection en polyéthylène
- Versions avec et sans aiguille
- Tête de piston en caoutchouc synthétique (polyisoprène) avec double joint d'étanchéité
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

UI = Unité Internationale


50 UI


100 UI

Omnican® 50 et Omnican® 100 pour insuline 100 U avec aiguille intégrée, fabriquée conformément à la norme ISO 8537

100 U

Volume maximal en UI	Graduation / valeur d'echelle	Ø x Longueur (Aiguille)	Unités par boîte	Référence
50 UI pour 100 U	100 U / 1 UI	0.30 x 8 mm	100 pièces	9151117S
50 UI pour 100 U	100 U / 1 UI	0.30 x 12 mm		9151125S
100 UI pour 100 U	100 U / 2 UI	0.30 x 8 mm		9151133S
100 UI pour 100 U	100 U / 2 UI	0.30 x 12 mm		9151141S

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Aiguilles pour stylo injecteur

Aiguilles pour stylo injecteur d'insuline

ATTENTION
Les aiguilles pour stylo injecteur sont des produits stériles à usage unique. L'utilisation multiple réduit la qualité et la sécurité. Changez l'aiguille du stylo après chaque injection ! Jetez les aiguilles usagées dans une boîte pour objets tranchants.



Omnican® Fine

Aiguilles pour stylo injecteur d'insuline



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Technologie à paroi extra-mince
- Canule en acier inoxydable avec finition en silicone
- Capuchon extérieur en polyèthylène
- Porte-aiguille en polypropylène
- Protection de l'aiguille en copolymère styrène-butadiène
- Sans PVC, Latex,DEHP et BPA
- Aiguilles de stylo stériles
- Compatible avec tous les principaux stylos disponibles sur le marché

Omnican® fine, fabriquée conformément à la norme ISO 11608-2

Produit	Gauge	Diamètre	Unités par boîte	Référence
Omnican® fine* 4 mm	31 G	0.25 mm	100 pièces	931G04S-41
Omnican® fine* 6 mm	31 G			931G06S-41
Omnican® fine* 8 mm	31 G			931G08S-41

* Technologie de paroi extra-mince

Aiguille pour stylo injecteur d'insuline, dispositif médical de classe IIa (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Aiguilles Hypodermiques sans ou avec mécanisme de sécurité


Sterican®, Sol-M™ et Sterican® Safety

Pour l'injection, B. Braun propose une gamme étendue d'aiguilles à usage unique à biseau court et à biseau long pour les applications standard. La gamme comprend également des aiguilles pour des indications spéciales, telles que l'administration d'insuline, les prélèvements sanguins et les injections intramusculaires.



Sterican®

Aiguilles hypodermiques

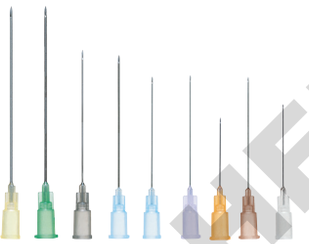

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en acier inoxydable chrome-nickel
- Embase de l'aiguille en polypropylène
- Aiguille siliconée à paroi mince
- Biseau long à trois facettes
- Embase colorée en fonction de la gauge de l'aiguille conforme à la norme ISO 6009
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

INDICATIONS

Les aiguilles hypodermiques Sterican® sont indiquées pour :

- Les prises de sang
- Les injections intraveineuses
- Les injections sous-cutanées
- Les injections intramusculaires
- Les injections dans les articulations et les tissus mous
- Les aspirations par aiguille fine
- Les injections intravitréennes

Sterican®, fabriqué selon la norme ISO 7864

Gauge x Longueur	Ø x Longueur	Type de biseau	Unités par boîte	Référence
20 G x 1 ½ "	0.90 x 40 mm	Biseau long	100 pièces	4657519
21 G x 1 ½ "	0.80 x 40 mm			4657527
22 G x 1 ¼ "	0.70 x 30 mm			4657624
23 G x 1 ¼ "	0.60 x 30 mm			4657640
23 G x 1 "	0.60 x 25 mm			4657667
24 G x 1 "	0.55 x 25 mm			4657675
25 G x 5/8 "	0.5 x 16 mm			4657853*
26 G x 1 "	0.45 x 20 mm			4657683
27 G x ¾ "	0.40 x 20 mm			4657705

*Pour une utilisation avec Injekt®, seringue à tuberculine (voir page 10)

Aiguille hypodermique, dispositif médical de classe IIa (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sterican® pour les indications spécifiques

Aiguilles hypodermiques conventionnelles avec embout Luer Lock

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en acier inoxydable chrome-nickel
- Embase de l'aiguille et clapet protecteur en polypropylène
- Aiguille siliconée à paroi mince
- Biseau long à trois facettes
- Embase colorée en fonction de la gauge de l'aiguille conforme à la norme ISO 6009
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

INDICATIONS

Les aiguilles hypodermiques Sterican® sont indiquées pour :

- Les prises de sang
- Les injections intraveineuses
- Les injections sous-cutanées
- Les injections intramusculaires
- Les injections dans les articulations et les tissus mous
- Les aspirations par aiguille fine
- Les injections intravitréennes



Sterican®, fabriqué selon la norme ISO 7864

Gauge x Longueur	Ø x Longueur	Type de biseau	Unités par boîte	Référence
19 G x 2 "	1.1 x 50 mm	Biseau long	100 pièces.	4665511
19 G x 1 ½ "	1.1 x 40 mm			4657799
19 G x 1 ¼ "	1.1 x 30 mm			4665317
20 G x 2 ¾ "	0.9 x 70 mm			4665791
20 G x 1 "	0.9 x 25 mm			4657500
21 G x 4 ¾ "	0.8 x 120 mm			4665643
21 G x 3 ⅛ "	0.8 x 80 mm			4665465
21 G x 2 "	0.8 x 50 mm			4665503
21 G x 1 "	0.8 x 25 mm			4657543
22 G x 1 ½ "	0.7 x 40 mm			4660021
23 G x 3 ⅛ "	0.6 x 80 mm			4665635
23 G x 2 ⅜ "	0.6 x 60 mm			4665600
25 G x 1 "	0.5 x 25 mm			9186158
25 G x 1 ½ "	0.5 x 40 mm			9186166
26 G x ½ "	0.45 x 12 mm			4665457*
27 G x ½ "	0.40 x 12 mm			4665406*
27 G x 1 ½ "	0.4 x 40 mm			9186182
27 G x 1 "	0.4 x 25 mm			9186174
30 G x ½ "	0.30 x 12 mm			4656300*
18 G x 1 ½ "	1.2 x 40 mm	Biseau court	100 pièces	4665120
18 G x 2 "	1.2 x 50 mm			4667123
19 G x 1 ½ "	1.1 x 40 mm			4665112
20 G x 2 "	0.9 x 50 mm			4667093

*Pour une utilisation avec Omnifix®, seringue à insuline (voir page 26)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SOL-M®

Aiguilles à biseau émoussé avec embout Luer Lock pour mélange de médicaments

UNIQUEMENT POUR LA PRÉPARATION ET LA RECONSTITUTION DES MÉDICAMENTS





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Aiguille avec et sans filtre de 5 microns
- Fabriqué en acier inoxydable chrome-nickel
- Biseau émoussé (45°)
- Embase colorée en rouge et violette en polypropylène
- Compatible avec embouts Luer et Luer Lock
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

SOL® M, fabriqué selon la norme ISO 7864

Produit	Gauge x Longueur	Ø x Longueur	Type de biseau	Angle du biseau	Unités par boîte	Référence
SOL-M® Aiguille de remplissage	18 G x 1 ½ "	1.2 x 40 mm	Biseau émoussé	45°	100 pièces	110022
SOL-M® Aiguille de remplissage	18 G x 2 "	1.2 x 50 mm				110023
SOL-M® Aiguille de remplissage avec filtre	18 G x 1 ½ "	1.2 x 40 mm				110022F
SOL-M® Aiguille de remplissage avec filtre	18 G x 2 "	1.2 x 50 mm				110023F

Aiguille à biseau émoussé, dispositif médical de classe IIa (CE 2797) | Fabriqué par : Sol-Millennium Medical Inc. | 1735 North Brown Road 120, Lawrenceville, 30043 Géorgie | États-Unis



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sterican® Safety

Aiguilles hypodermiques de sécurité avec embout Luer Lock et longueur du biseau selon l'indication



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en acier inoxydable chrome-nickel
- Embase de l'aiguille et clapet protecteur en polypropylène
- Aiguille siliconée à paroi mince
- Biseau long à trois facettes
- Conforme à la directive européenne (2010/32/UE)
- Embase colorée en fonction de la gauge de l'aiguille conforme à la norme ISO 6009
- Sans PVC, Latex et DEHP
- Emballage individuel stérile

INDICATIONS

Les aiguilles hypodermiques de sécurité Sterican® Safety sont indiquées pour :

- Les prises de sang
- Les injections intraveineuses
- Les injections sous-cutanées
- Les injections intramusculaires
- Les injections dans les articulations et les tissus mous
- Les aspirations par aiguille fine
- Les injections intravitréennes

Sterican® Safety, fabriqué selon la norme ISO 7864

Gauge x Longueur	Ø x Longueur	Type de biseau	Unités par boîte	Référence
30 G x ½ "	0.30 x 13 mm			4670002S-01
27 G x ½ "	0.40 x 13 mm			4670005S-01
26 G x ½ "	0.45 x 13 mm			4670008S-01
25 G x 5/8 "	0.50 x 16 mm			4670012S-01
25 G x 1 "	0.50 x 25 mm			4670016S-01
25 G x 1 ½ "	0.50 x 40 mm			4670020S-01
24 G x 1 "	0.55 x 25 mm			4670022S-01
23 G x 1 "	0.60 x 25 mm			4670025S-01
23 G x 1 ¼ "	0.60 x 30 mm			4670027S-01
23 G x 1 ½ "	0.60 x 40 mm			4670028S-01
22 G x 1 "	0.70 x 25 mm	Biseau long	100 pièces	4670030S-01
22 G x 1 ¼ "	0.70 x 30 mm			4670032S-01
22 G x 1 ½ "	0.70 x 40 mm			4670035S-01
21 G x 1 "	0.80 x 25 mm			4670040S-01
21 G x 1 ¼ "	0.80 x 30 mm			4670042S-01
21 G x 1 ½ "	0.80 x 40 mm			4670045S-01
20 G x 1 "	0.90 x 25 mm			4670047S-01
20 G x 1 ½ "	0.90 x 40 mm			4670050S-01
19 G x 1 ½ "	1.10 x 40 mm			4670052S-01
18 G x 1 "	1.20 x 25 mm			4670053S-01
18 G x 1 ½ "	1.20 x 40 mm			4670055S-01

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Sterican® Safety


Description du produit



Verrouillage sécurisé

- Trois crochets permettent de sécuriser le verrouillage de l'aiguille
- Indicateur sonore et visuel confirme la mise en sécurité de l'aiguille

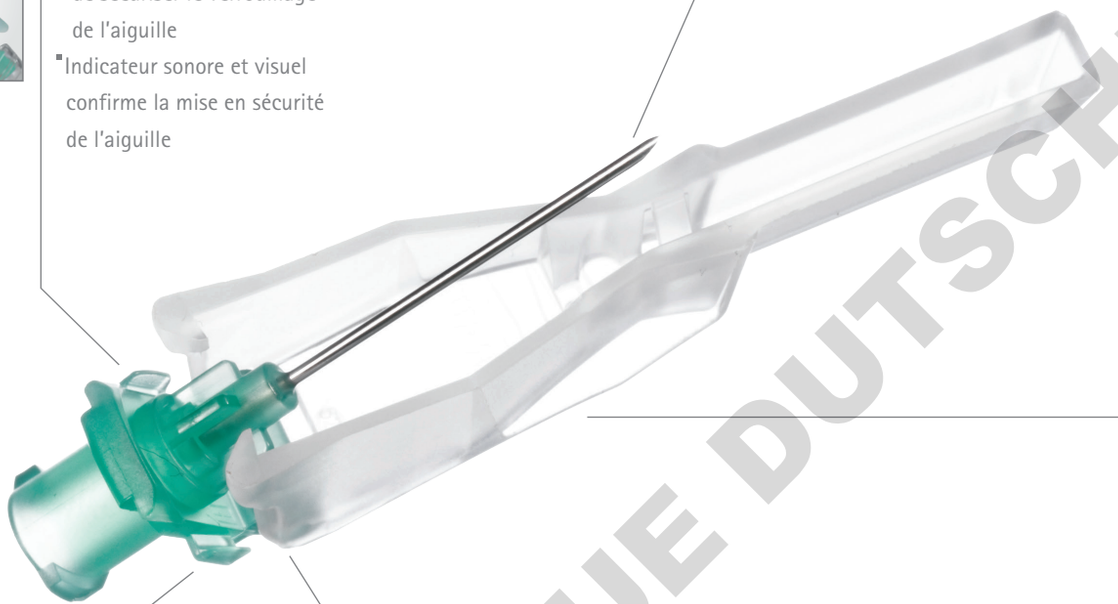



Orientation du biseau

- Le biseau est orienté côté clapet de sécurtié.



Mécanisme de sécurité

- Le clapet de sécurité offre une protection contre les blessures par piquants tranchants lorsqu'il recouvre l'aiguille.




Activation simple

- L'activation de la sécurité se fait à une main, assurant son positionnement derrière l'aiguille.
- Bonne préhension sur le plateau du clapet de sécurité.



Conception monobloc

- La conception de ce dispositif assure son intégrité en une seule pièce. Cela prévient d'une désolidarisation pendant l'usage



Charnière ajustable

- La charnière permet d'ajuster la position du clapet de sécurité en accord avec la manipulation à effectuer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disponible dans les tailles 30G-18G
- Compatible avec toutes les seringues standard Luer-Lock et Luer-Slip.
- Aiguille en acier inoxydable
- Embase et clapet de sécurité en polypropylène
- Conforme à la directive européenne 2010/32/EU
- Code couleur conforme à la norme ISO 6009

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Aiguille hypodermique sécurisée, dispositif médical de classe IIa (CE 0123) | Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun str.1 | 34212 Melsungen | Allemagne

Sterican® Safety

Instruction de manipulation



Sortez l'aiguille Sterican® Safety de son emballage après avoir vérifié son intégrité.



Tenez le dispositif au niveau de la base du clapet de sécurité transparent et connectez l'aiguille sécurisée à n'importe quelle seringue présentant une connectique Luer-Lock ou Luer-Slip en effectuant un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.




Tenez la seringue à une main et avec la deuxième, déployez le clapet vers l'arrière en direction de la seringue.



Retirez prudemment le capuchon protecteur de l'aiguille.




Effectuez la manipulation selon le protocole de l'établissement.

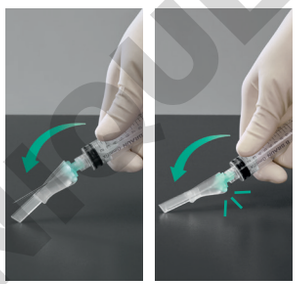

Deux méthodes sont possibles pour activer le mécanisme de sécurité:

1. Appuyez sur le clapet de protection contre une surface dure et plate jusqu'à ce que vous entendiez un clic sonore.

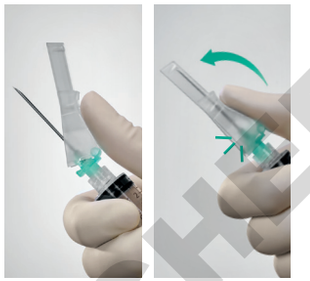

2. Appuyez avec votre pouce sur le clapet de sécurité de façon à ce qu'il vienne se positionner sur l'aiguille. La sécurité est en place lorsque vous entendez un clic sonore.



Confirmez visuellement la sécurisation de l'aiguille avant de l'éliminer.



Après activation de la sécurité, déposer immédiatement l'aiguille usagée dans un conteneur homologué pour les objets tranchants suivant les procédures normalisées de votre établissement et/ou selon la reglementation applicable à la mise au rebut des objets tranchants.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Medibox®

Conteneurs pour l'élimination des DASRI




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Les conteneurs Medibox sont conformes aux normes internationales ISO 23907, ADR2015 et 2008/68/CE (sauf Medibox 0,7 L).
- Résistant aux chocs et aux perforations conformément à la norme ISO 23907
- Conteneur et couvercle en polypropylène

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Entrées sans contact, à rotation et à insertion pour tous les types d'aiguilles Luer et Luer Lock usagées ainsi que les aiguilles de stylo.
- Grande ouverture pour faciliter l'insertion des instruments médicaux tranchants
- Fermeture temporaire facile à utiliser
- Mécanisme de verrouillage final irréversible
- Avertissement de débordement par la ligne de remplissage maximum



Medibox® 2.4 L – 9.1 L



Medibox® 0.7 L

PERMET L'ÉLIMINATION DES

1. Aiguilles Luer et Luer-Lock
2. Aiguilles pour stylos à insuline
3. Instruments médicaux tranchants
4. Désolidarisation embases des stylos injecteurs

Volume total	Volume maximal	Dimension (L x l x H)	Base (L x l)	Unités par boîte	Référence
0.8 L	0.67 L	18.4 x 9.9 x 9.9 cm	18.4 x 9.9 cm	18 pièces	9193424
2.4 L	2.0 L	15.1 x 15.2 x 20 cm	11 x 11 cm	27 pièces	9193600
4.7 L	3.9 L	19 x 19 x 20.5 cm	15 x 15 cm	25 pièces	9193618
5.7 L	4.8 L	19 x 19 x 25.7 cm	13.9 x 13.9 cm	25 pièces	9193627
6.8 L	5.7 L	16.7 x 16.7 x 50 cm	Ø 11 cm	22 pièces	9193639
9.1 L	7.7 L	21.5 x 21.5 x 32.5 cm	17 x 17 cm	13 pièces	9193640

DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux. Medibox n'est pas un dispositif médical.

DOMINIQUE DUTCHER SAS

Medibox®

Instruction de manipulation

1 ASSEMBLAGE DU COUVERCLE





Placez le couvercle sur le conteneur de déchets et appuyez fermement sur les coins opposés du couvercle jusqu'à ce qu'un "clic" confirme le verrouillage.

Vérifier que le couvercle est bien verrouillé de tous les côtés !


2 ELIMINATION



Ouvrez le couvercle en exerçant une légère pression sur la languette - le rabat du couvercle saute légèrement vers le haut.



Poussez le rabat du couvercle d'une main, jusqu'à ce qu'il se verrouille en position debout.



PERMET L'ÉLIMINATION DES

1. Aiguilles Luer et Luer-Lock
2. Aiguilles pour stylos à insuline
3. Instruments médicaux tranchants



Débranchez les connexions Luer et Luer-Lock entre la seringue et la canule.





Dévissez l'aiguille d'un stylo.



Éliminer les gros objets tranchants à usage médical.

3 FERMETURE DU COUVERCLE



FERMETURE TEMPORAIRE :
Libérez le rabat du couvercle de la position debout et pressez-le légèrement sur le boîtier.



FERMETURE DÉFINITIVE :
Fermez la Medibox® après avoir atteint le volume de remplissage maximal (voir la ligne de marquage sur le couvercle) en appuyant simultanément sur les points de pression marqués.





Jetez la Medibox® fermée conformément au protocole de l'établissement.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Notes

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Produits non remboursés par l'Assurance Maladie à l'Hôpital.
Pour les conditions de prise en charge au titre de la LPPR, se reporter au site ameli.fr

Les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document et photos non contractuels.
Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

B. Braun Medical I 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud
Tel : 01 41 10 53 00 I Fax : 01 70 83 45 00 I www.bbraun.fr
B. Braun Medical S.A.S. au capital de 31 000 000 euros RCS NANTERRE 562 050 856

Réf. 301777P_20220607_20270607
Edition Juin 2022

DOMINIQUE DUTSCHER SAS